

FICHE D'INCIDENT

GRAVE :

**EPREUVE TECHNIQUE DU
CONTRÔLE ULTIME DANS
UN ES – FEV MARS 2018**

018
083

U.F : 32
Nom agent : _____
Date : 07/02/18
Signature : _____

Validité des serum-test contrôlée : Oui Non

Patient O
CGR O

Goutte de sang	ANTI A	ANTI B	Conforme au groupe du patient :
			<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
			Je transfuse : <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
			Je transfuse : <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
			Je transfuse : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

N° CGR
04 17 16 9180
346119
(étiquette)

N° CGR patient.
(étiquette)

N° CGR
6 8621 18
(étiquette)


POUR UN MEME REACTIF, SI LE PATIENT N'AGGLUTINE PAS ALORS QUE LE CGR AGGLUTINE : INTERDICTION DE TRANSFUSER !

CONCEPTION / ACTUALISATION	Correspondant d'Hémovigilance : N. RIVET	15/12/2016
VALIDATION	Correspondant d'Hémovigilance : N. RIVET	15/12/2016
APPROBATION	Ingénieur Qualité-Gestion des Risques : S. FEUILLET	15/12/2016

Mise à jour de la V6 diffusée le 23/07/2013
La version électronique de ce document est la version de référence.

lot 350518 3/01/18

Test sur carton du même lot

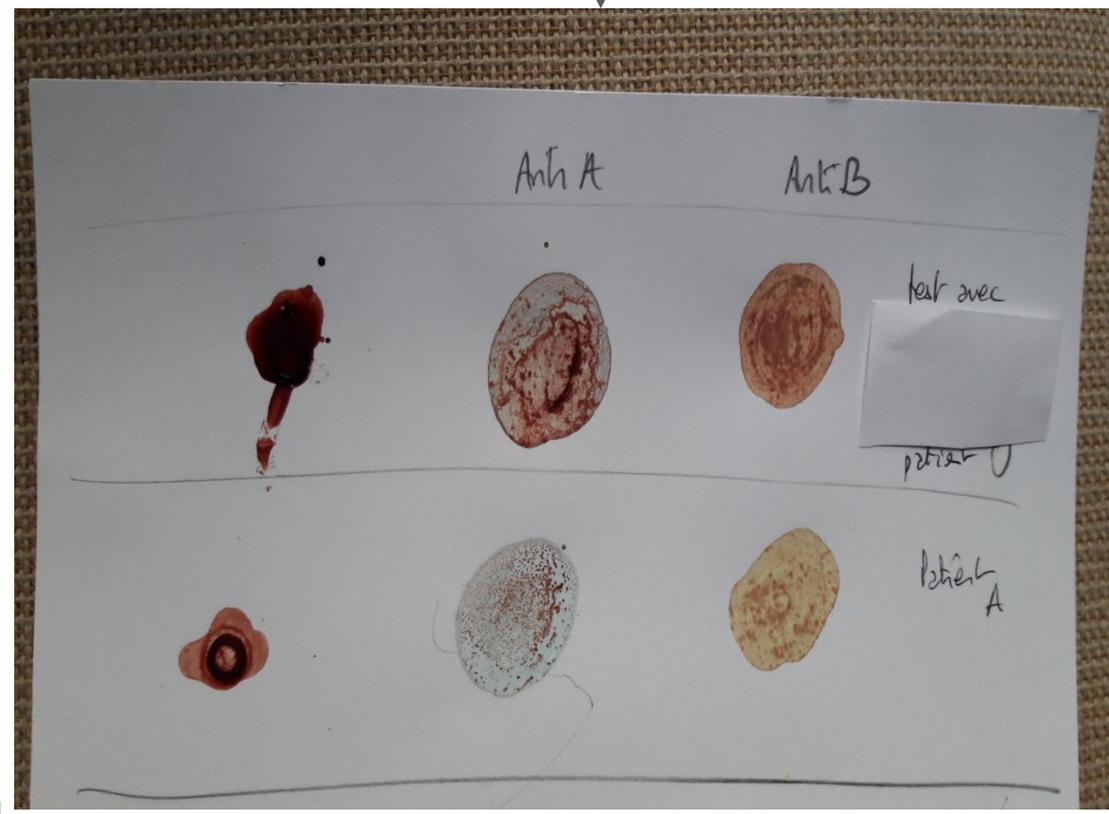

AGREGATS !!!!!

**Incident
lors du
CUPT**

Etape 1
(8 février)
Information et
récupération
de tous les
cartons

Etape 2
(8 février) :
**tous les lots
sont testés**

Etape 3
(8/02 au 20
avril) :
**Distribution
d'un carton
avec chaque
CGR**

Etape 4
(après 17 avril)
CSTH décide
recours aux
cartons
industriels

SECURISATION DE L'ÉPREUVE TECHNIQUE DU CONTRÔLE ULTIME